

EMBLEM SYSTEM

1. 엠블럼 콘셉
2. 엠블럼 유형
3. 컬러시스템
4. 전용색상
5. 색상활용
6. 금지규정
7. 지정서체

EMBLEM SYSTEM

Emblem Concept

ES 01

엠블럼 콘셉

다양한 연구와 기술의 융합을 통한 국민 건강의 가치 창출을 지향하는 병원평가통합포털의 창조적 정신을 상징하고 월계수는 불멸의 상징으로 시들지 않는 (국민의)영원한 젊음을 상징하며, 고대 그리스 로마시대에 경기의 승리자나 전투의 승리자에게 월계수 잔가지로 엮는 관을 만들어 씌어준 유래를 메타포로 우수 평가기관의 영광과 명예를 나타낸다.



EMBLEM SYSTEM

Emblem category (for press)

ES 02_1

엠블럼 유형

다양한 연구와 기술의 융합을 통한 국민 건강의 가치 창출을 지향하는 병원평가통합포털의 창조적 정신을 상징하고 월계수는 불멸의 상징으로 시들지 않는 (국민의)영원한 젊음을 상징하며, 고대 그리스 로마시대에 경기의 승리자나 전투의 승리자에게 월계수 잔가지로 엮는 관을 만들어 씌어준 유래를 메타포로 우수 평가기관의 영광과 명예를 나타낸다.

인증엠블럼-기본 (인쇄용)

평가우수기관_ Blue&Gold



인증엠블럼-기본 (에칭 현판용)

평가우수기관_ Gold



인증엠블럼-기본 (각 등급별 적용예)



Minimum Sizing
15mm



EMBLEM SYSTEM

Emblem category (for web)

ES 02_2

엠블럼 유형

다양한 연구와 기술의 융합을 통한 국민 건강의 가치 창출을 지향하는 병원평가통합포털의 창조적 정신을 상징하고 월계수는 불멸의 상징으로 시들지 않는 (국민의)영원한 젊음을 상징하며, 고대 그리스 로마시대에 경기의 승리자나 전투의 승리자에게 월계수 잔가지로 엮는 관을 만들어 씌어준 유래를 메타포로 우수 평가기관의 영광과 명예를 나타낸다.

인증엠블럼-웹 게시용 (약장)

120px_(현사이즈 30%축소)



60px_(현사이즈 50%축소)



32px_(현사이즈 50%축소)



텍스트형 A  X 대장암평가 3회연속 1등급

텍스트형 B  X 대장암평가 3회연속 1등급

Minimum Sizing
32px




EMBLEM SYSTEM

Color System

ES 03


컬러시스템

전용색상은 심볼과 더불어 병원평가통합포털의 이미지를 전달하는 중요한 기능을 한다. 전용색상의 효과적인 사용을 위해서는 인쇄방법, 잉크의 농도, 종이의 재질, 적용매체의 상황 등을 검토하여 본 항이 정한 표준색상을 유지하도록 한다. 인쇄시에는 본 항에 기재된 CMYK 값을, 웹 적용 시에는 RGB를 기준으로 한다.




KHQA BLUA 01

Hex 014b75
RGB 1 / 75 / 117
CMYK 95 / 73 / 39 / 2
Pantone 7701C




KHQA Gradient

Blue Gradient




KHQA BLUA 02

Hex 724720
RGB 114 / 71 / 32
CMYK 55 / 73 / 100 / 26



KHQA Gradient

Gold Gradient



KHQA BLUA 03

Hex d1aa4a
RGB 209 / 170 / 74
CMYK 21 / 35 / 78 / 0

EMBLEM SYSTEM

Color System

ES 03-1



색상활용

색상활용은 병원평가통합포털의 이미지를 어떠한 조건에서도 일관되게 표현하기 위한 색상활용 지침으로 배경색상 및 재료에 따라 표현할 수 있는 색상 범위를 예시한 것으로 정확한 색상표현이 유지될 수 있도록 세심하게 관리하여야 한다.

흑백 색상 배경 활용



전용 색상 배경 활용

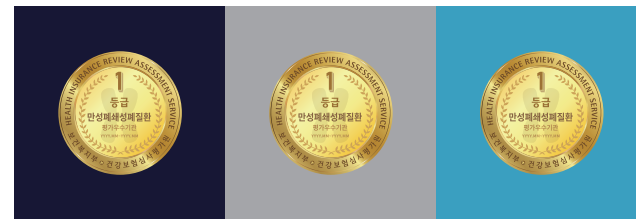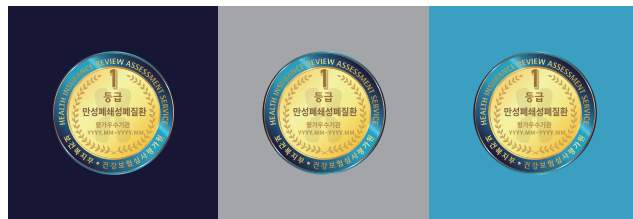

EMBLEM SYSTEM


Incorrect Use

ES 04

금지규정

엠블럼은 항상 그 형태와 존재감이 유지되어야 한다. 본 항은 엠블럼이 왜곡되거나 존재감이 훼손되는 등의 이미지 손상이 발생하지 않도록 세심한 주의를 기울여야 하는 사용금지 규정이다.

엠블럼의 크기와 비율은 적절하게 유지되어야 하며 로고가 늘어나거나, 기울어지거나, 잘못된 색상으로 사용되어서는 안 된다. 엠블럼 사용의 잘못된 예를 참고해 엠블럼 활용에 각별히 주의해야 한다.

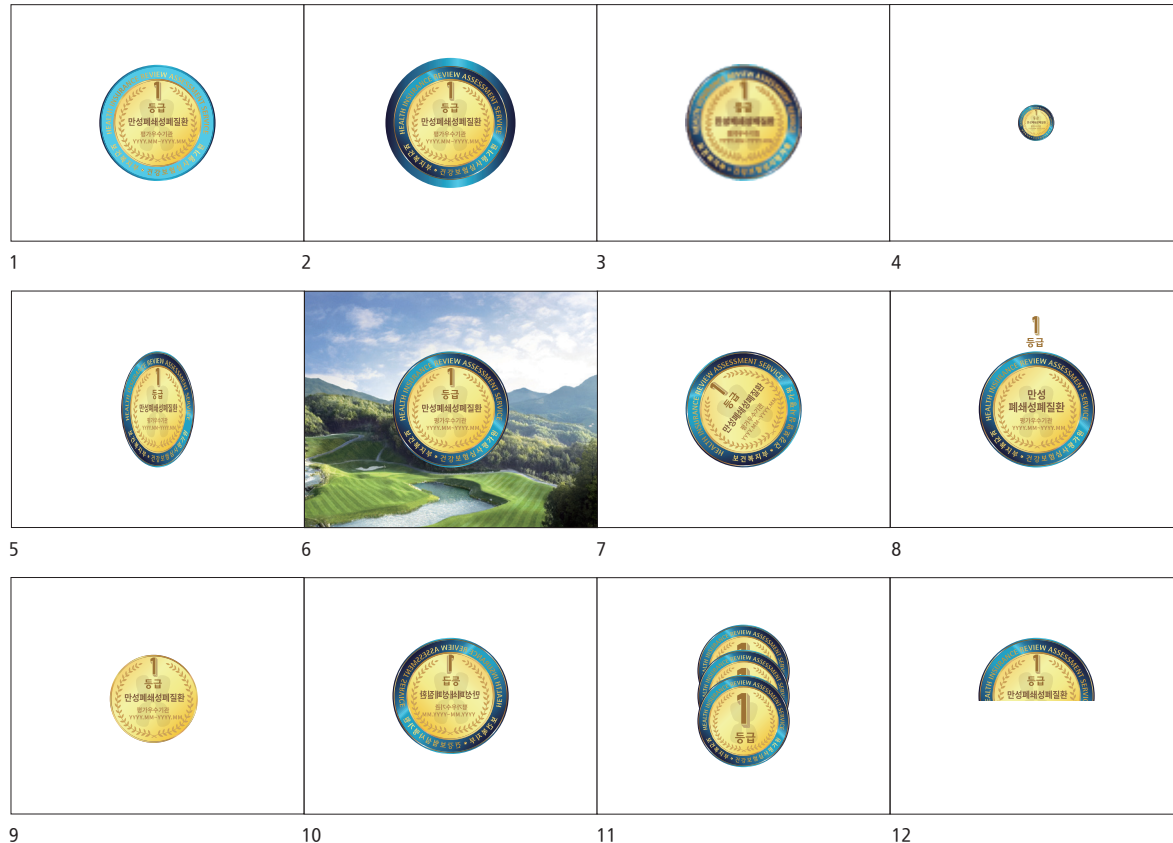

- 1 제안된 색상 이외의 색상으로 엠블럼을 설정 금지
- 2 윤곽선 확대 형태의 엠블럼 사용 금지
- 3 해상도를 지나치게 낮춘 엠블럼 사용 금지
- 4 최소 사이즈 규정보다 작게 엠블럼 사용 금지
- 5 엠블럼을 늘리거나 압축 금지
- 6 지나치게 복잡한 배경위에 엠블럼 배치 금지
- 7 엠블럼을 기울이거나 회전 금지
- 8 엠블럼의 자간과 위치를 변경하여 사용 금지
- 9 엠블럼 일부를 자르거나 변형하여 사용 금지
- 10 반사되거나 뒤집어진 엠블럼 사용 금지
- 11 세로형으로 엠블럼 사용 금지
- 12 잘린 형태의 엠블럼 사용 금지

EMBLEM SYSTEM

Typeface

ES 05

전용서체

HIRA Sans는 병원평가통합포털을 대표하는 서체로, 브랜드 아이덴티티와 인지도를 높이기 위해 통일되고 조화롭게 사용하도록 한다.

의미를 강조할 때 적합한 B와 가독성을 높일 때 좋은 M, L 3가지로 구성되어있다.

(HIRA Sans) Bold.TTF

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890`⌘!@#\$%^&*()_~+=[]{}|\;:'"<>?.,/

(HIRA Sans) Medium.TTF

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890`⌘!@#\$%^&*()_~+=[]{}|\;:'"<>?.,/

(HIRA Sans) Ligth.TTF

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890`⌘!@#\$%^&*()_~+=[]{}|\;:'"<>?.,/